

с измерений погр. (4716) 730747
Lidant

регла и записки полев.
9106605551 для Козин

Диплом
ES 9300

№ 901.71.06
msk@dipaul.ru
Универсальный измеритель


SELEDATA®

SMHB 057.077.047

M = 1.95 Nm S = 1.8 Deg

I = 4.7 A / Phase

06
12

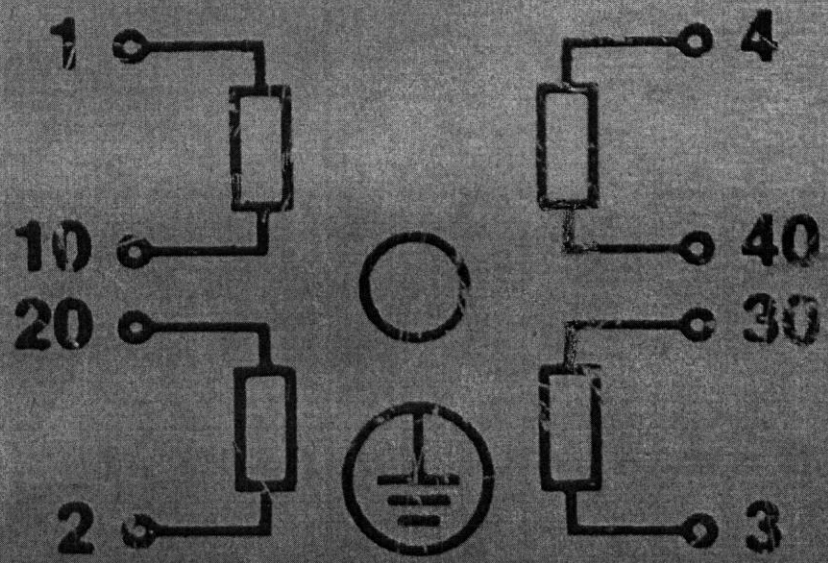

$T_{max} = 130^{\circ}C$

Swiss Made - Selectron Lyss AG - CH-3250 Lyss